



东莞市高升电子精密科技有限公司

口腔锥形束CT性能模体

产品技术规格书

制作单位：东莞市高升电子精密科技有限公司
单位地址：广东省东莞市大朗镇创意产业园 B 栋 1 楼
联系人：张继高
联系方式：18128028677（微信同号）
[Http://:www.delta17.cn](http://www.delta17.cn)
E-mail: 18128028677@163.com

感谢

您对我公司产品的关注！我们将为您量身定做适合贵公司产品的试验方案、制造试验设备及夹具、提供与国际接轨的试验技术以及强大的售后保障体系。

口腔锥形束CT性能模体

1. 产品介绍与结构

口腔锥形束CT性能模体的主体由直径为16cm的PMMA圆柱体组成，模体中有一块3mm厚的盖板，一块高对比度分辨力测试模块，一块低对比度分辨力测试模块，3个方向上的线对和一个定位支架。

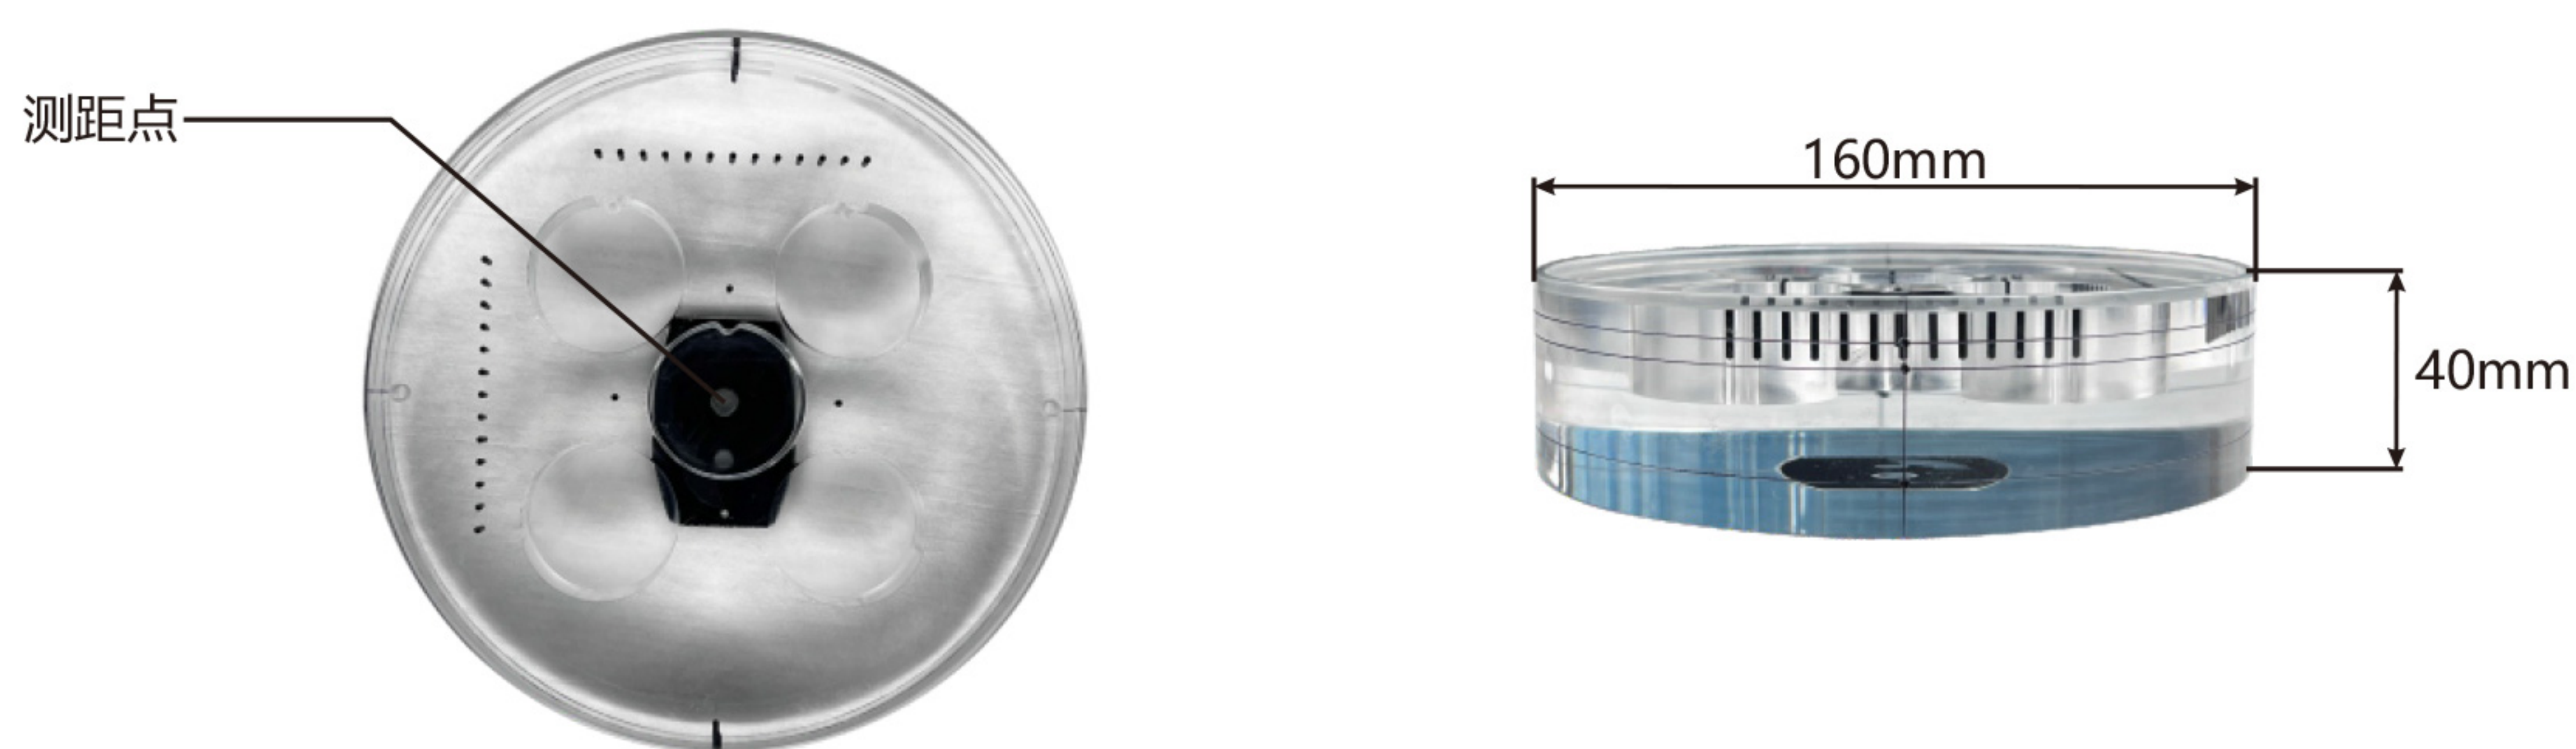


图 A.1 PMMA主体

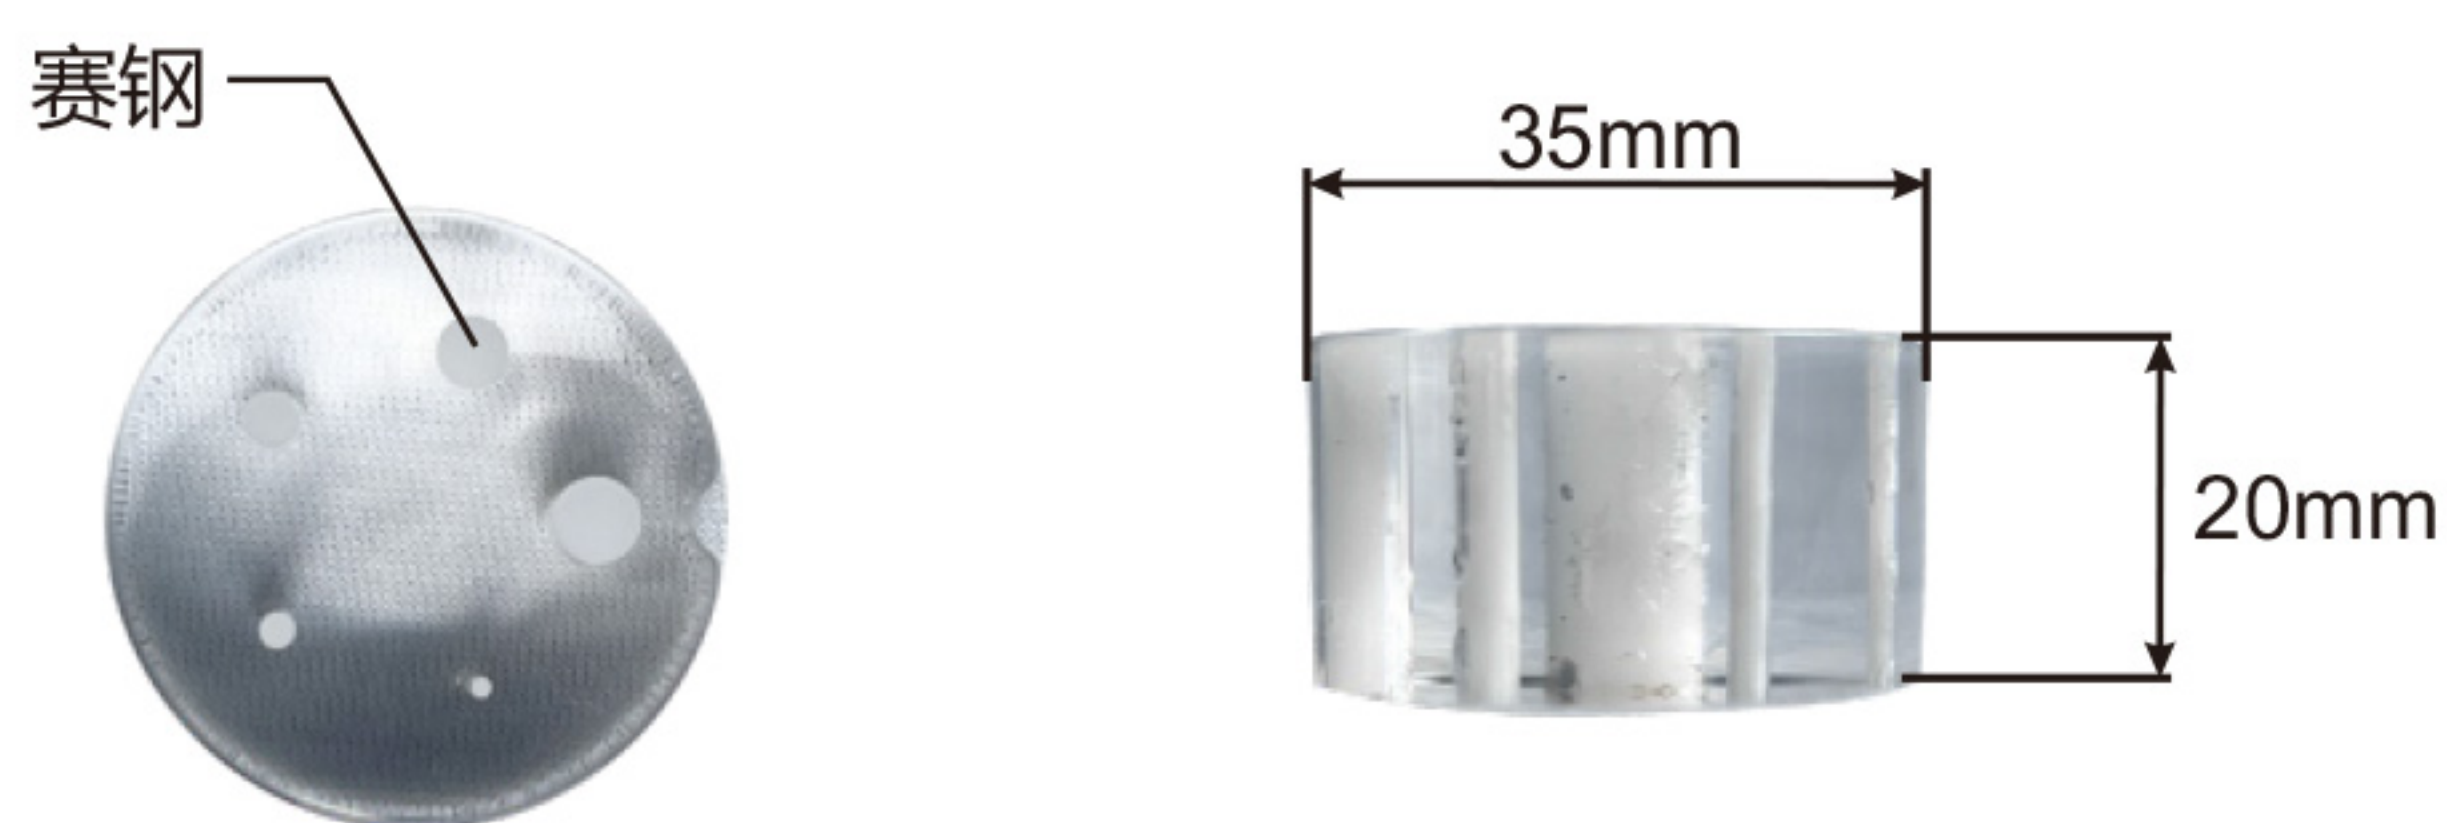


图 A.2 高对比度分辨力测试模块

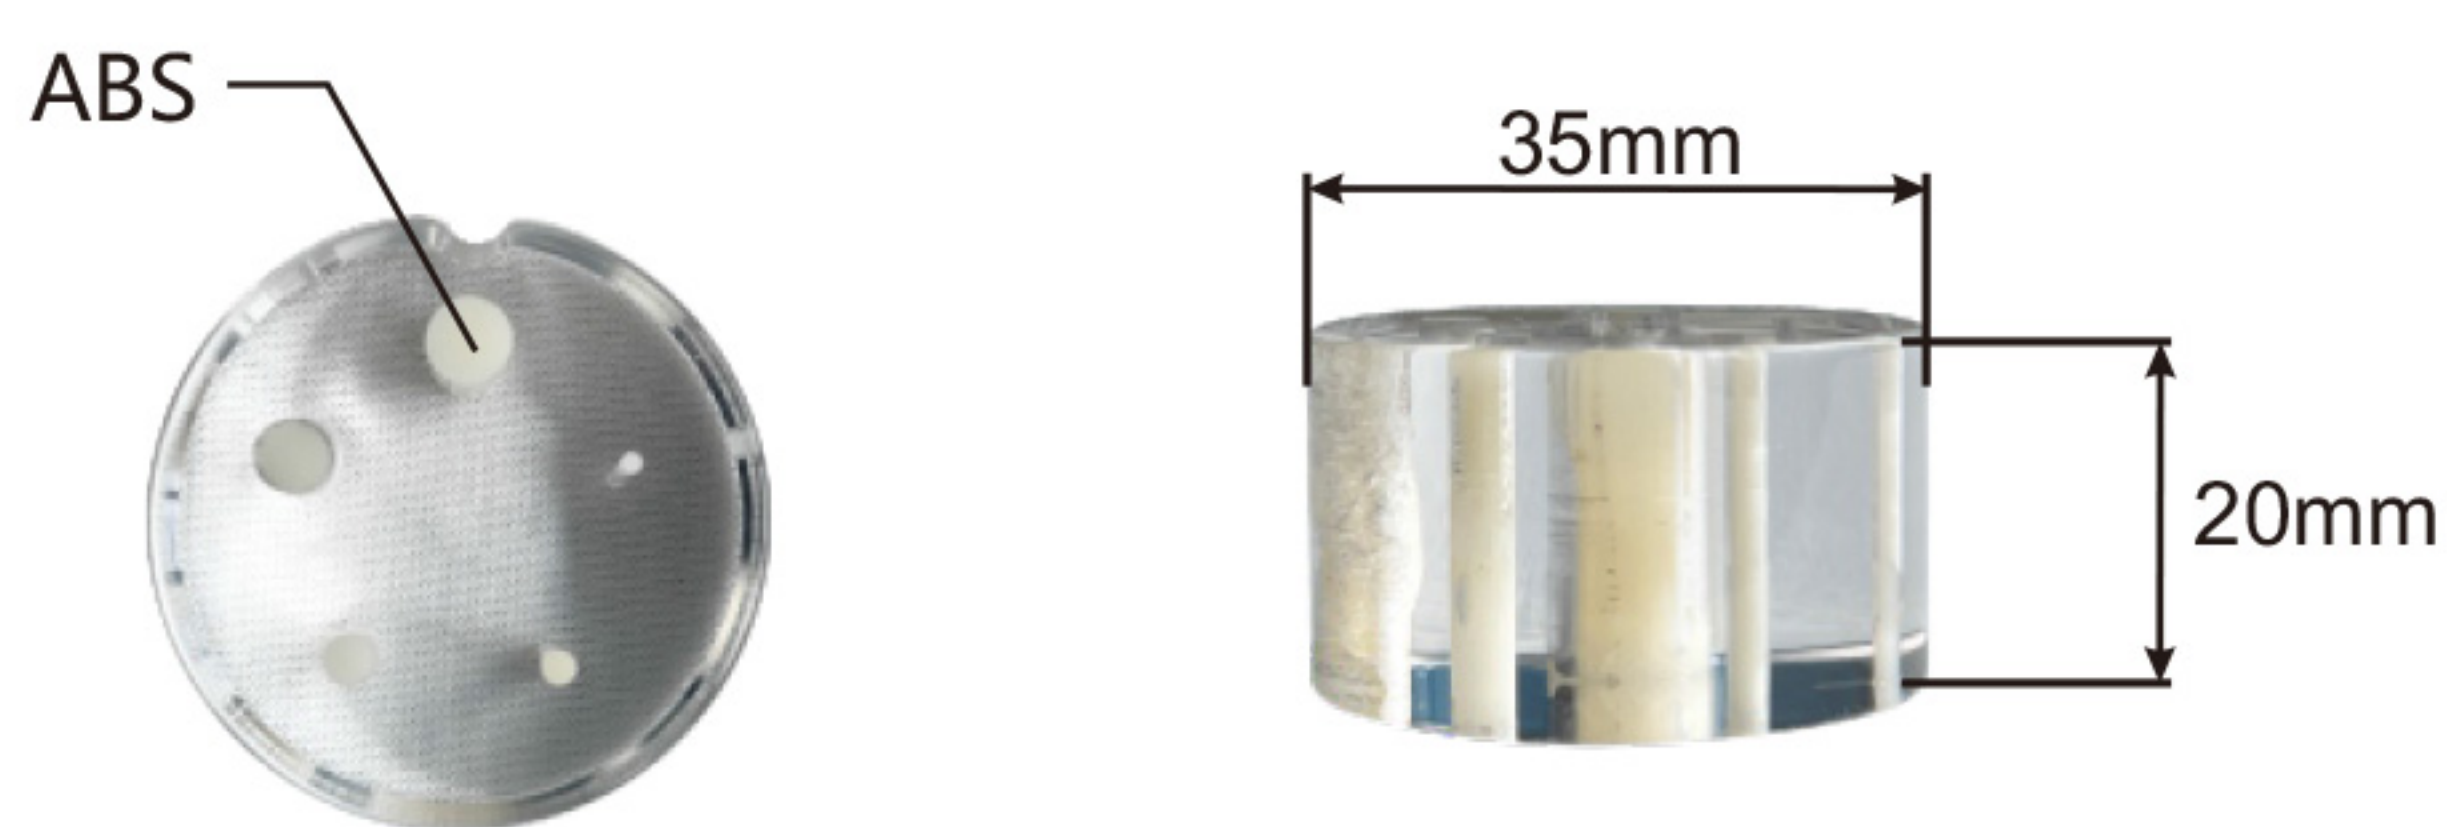


图 A.3 低对比度分辨力测试模块



图 A.4 3个方向上的线对



图 A.5 口腔锥形束CT性能模体

模体参数

名称	PMMA主体	盖板	高对比度分辨率测试模块	低对比度分辨率测试模块	3个方向上的线对	圆形水平尺
图片						
直径 mm	160	156	35	35	35	32
厚度 mm	40	3	20	20	20	7
数量	1个	1个	1个	1个	各1个	1个